




수술 보고서

주문서 세부 정보

승인됨

환자 이름: 분당서울대학병원 이상분 34 35 37
 고객 주문 참조: 68270_20230814_1652_23 (1) (1)
 작성 날짜: 2023-08-22 오전 8:39:27
 승인자: Default user - millingcenter@dentium.com
 (a36e3407-5a7b-426b-9549-a6e50087bf19)

하악


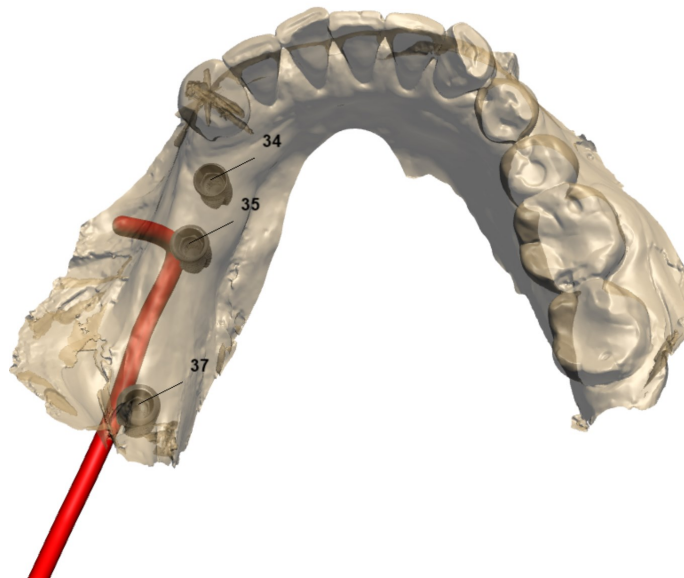


임플란트 정보					
임플란트 위치 (FDI)	34		35		37
제조업체	Dentium		Dentium		Dentium
유형	Dentium SuperLine P3.7 D3.6 L10.0		Dentium SuperLine D4.0 L10.0		Dentium SuperLine D4.5 L10.0
주문 번호	FXS3610		FXS4010		FXS4510
길이, mm	10		10		10
직경(Ø), mm	3.6		4		4.5
색상	Yellow		Green		Blue

책임 제한:

본 지침에는 작업 전에 의사가 제안하는 수술 계획을 기반으로 하는 사용자 지정 문서가 포함되어 있습니다. 따라서 의사는 서지컬 가이드, 수술 트레이 키트, 임플란트, 슬리브 등 공급업체에서 수신한 주문 양식에 지정된 모든 항목의 디자인과 적용에 대해 전적으로 책임을 집니다. 사용자 지정 문서는 케이스와 관련하여 함께 전송되는 모든 다른 문서에 대한 추가 문서로 간주되며 다른 문서를 대체하지 않습니다.




임플란트 정보		
임플란트 위치 (FDI)	34	
제조업체	Dentium	
유형	Dentium SuperLine P3.7 D3.6 L10.0	
주문 번호	FXS3610	
길이, mm	10	
직경(Ø), mm	3.6	
색상	Yellow	
안전 영역 - 치근단 거리	0.7 (사용자 지정)	
안전 영역 - 방사상 거리	0.1 (사용자 지정)	

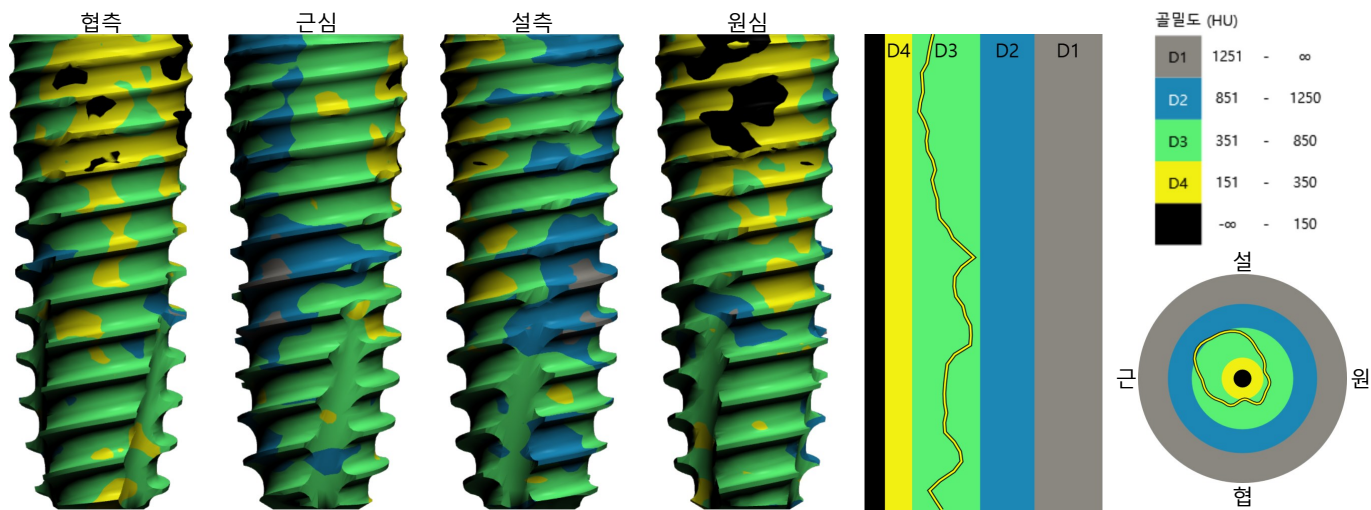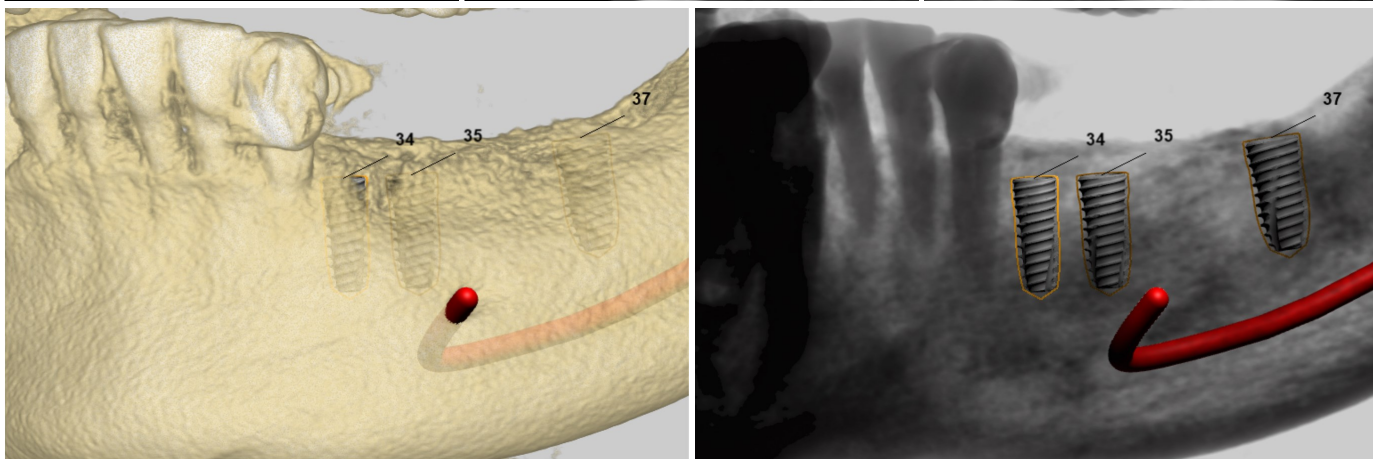

책임 제한:

본 지침에는 작업 전에 의사가 제안하는 수술 계획을 기반으로 하는 사용자 지정 문서가 포함되어 있습니다. 따라서 의사는 서지컬 가이드, 수술 트레이 키트, 임플란트, 슬리브 등 공급업체에서 수신한 주문 양식에 지정된 모든 항목의 디자인과 적용에 대해 전적으로 책임을 집니다. 사용자 지정 문서는 케이스와 관련하여 함께 전송되는 모든 다른 문서에 대한 추가 문서로 간주되며 다른 문서를 대체하지 않습니다.



임플란트 정보		
임플란트 위치 (FDI)	35	
제조업체	Dentium	
유형	Dentium SuperLine D4.0 L10.0	
주문 번호	FXS4010	
길이, mm	10	
직경(Ø), mm	4	
색상	Green	
안전 영역 - 치근단 거리	0.7 (사용자 지정)	
안전 영역 - 방사상 거리	0.1 (사용자 지정)	

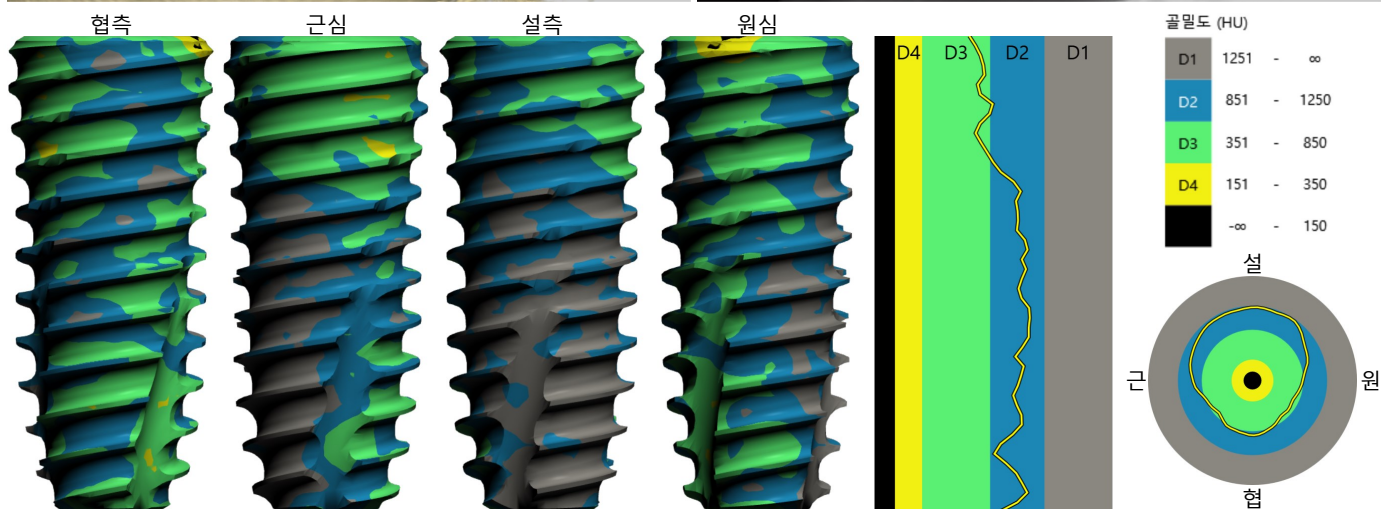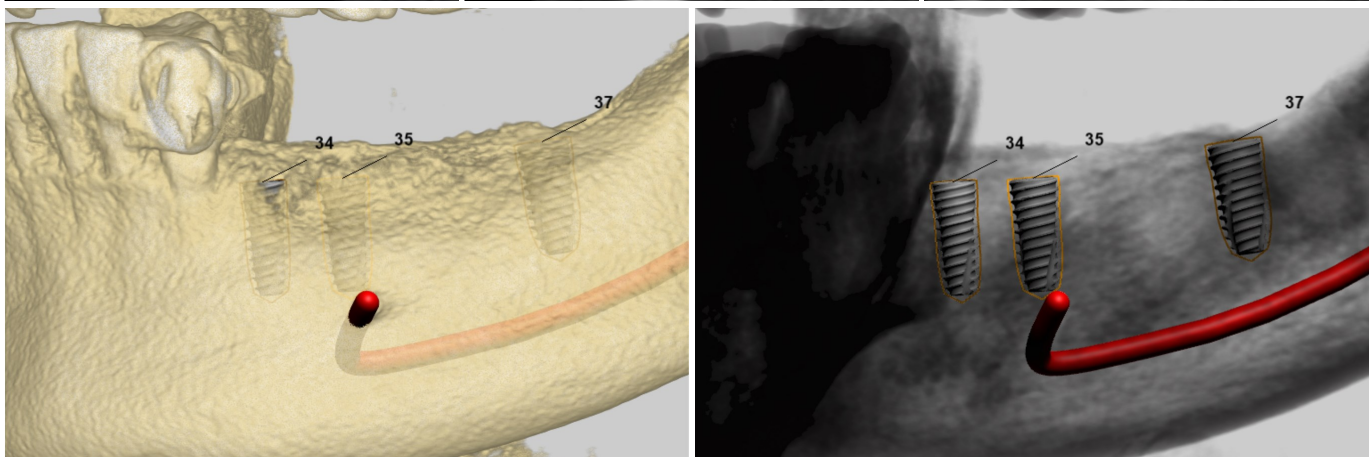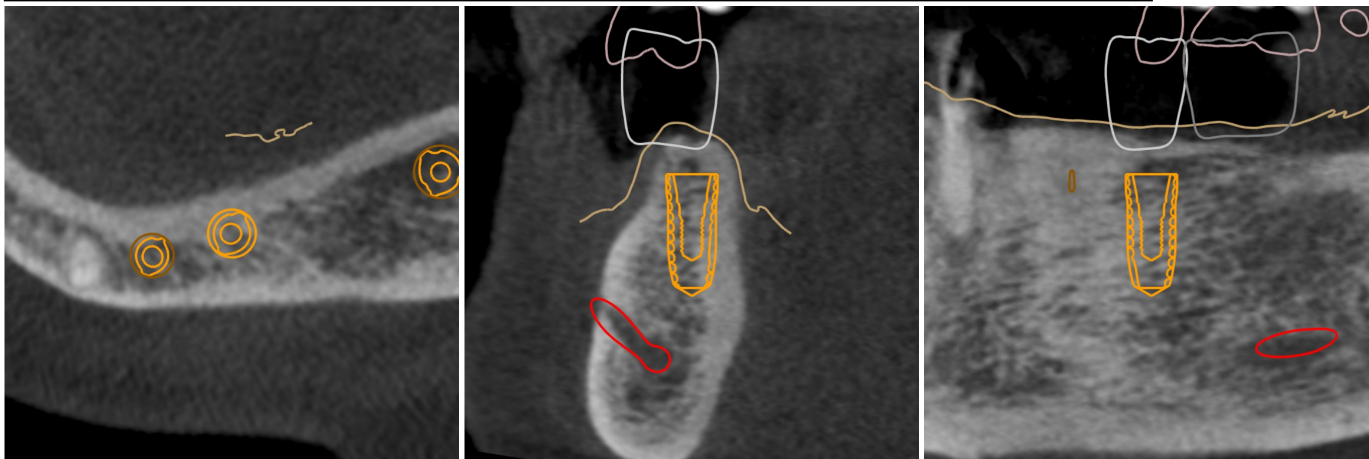

책임 제한:

본 지침에는 작업 전에 의사가 제안하는 수술 계획을 기반으로 하는 사용자 지정 문서가 포함되어 있습니다. 따라서 의사는 서지컬 가이드, 수술 트레이 키트, 임플란트, 슬리브 등 공급업체에서 수신한 주문 양식에 지정된 모든 항목의 디자인과 적용에 대해 전적으로 책임을 집니다. 사용자 지정 문서는 케이스와 관련하여 함께 전송되는 모든 다른 문서에 대한 추가 문서로 간주되며 다른 문서를 대체하지 않습니다.

임플란트 정보		
임플란트 위치 (FDI)	37	
제조업체	Dentium	
유형	Dentium SuperLine D4.5 L10.0	
주문 번호	FXS4510	
길이, mm	10	
직경(Ø), mm	4.5	
색상	Blue	
안전 영역 - 치근단 거리	0.7 (사용자 지정)	
안전 영역 - 방사상 거리	0.1 (사용자 지정)	

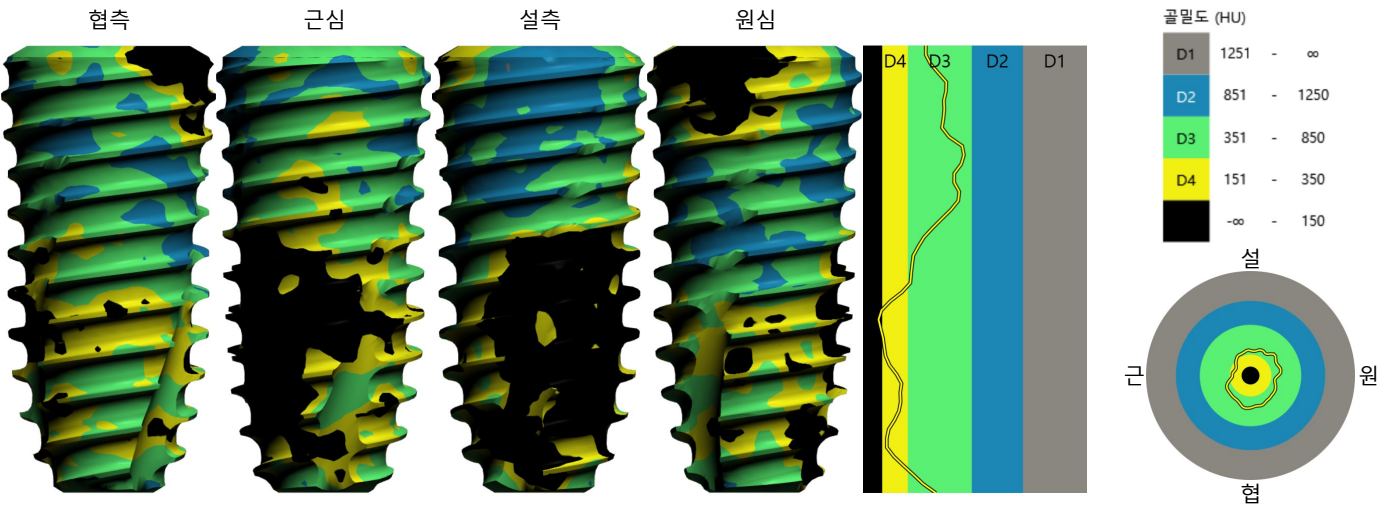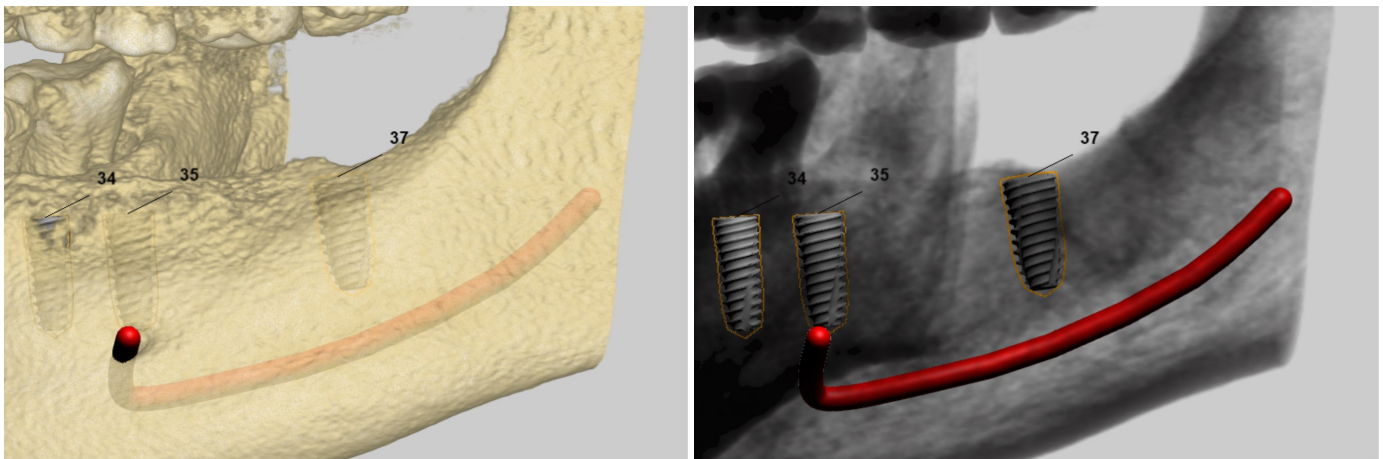

책임 제한:

본 지침에는 작업 전에 의사가 제안하는 수술 계획을 기반으로 하는 사용자 지정 문서가 포함되어 있습니다. 따라서 의사는 서지컬 가이드, 수술 트레이 키트, 임플란트, 슬리브 등 공급업체에서 수신한 주문 양식에 지정된 모든 항목의 디자인과 적용에 대해 전적으로 책임을 집니다. 사용자 지정 문서는 케이스와 관련하여 함께 전송되는 모든 다른 문서에 대한 추가 문서로 간주되며 다른 문서를 대체하지 않습니다.